

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «НЦГБ»
И.Г.Шеменкова
« 10 » 06 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг по ремонту стерилизатора парового ГПД-560-2

1. Общие требования

1.1. Наименование подлежащих закупке:

услуг по ремонту стерилизатора парового ГПД-560-2

1.2. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200

1.3. Ориентировочная стоимость государственной закупки: 1222,00

1.4.Источник финансирования: бюджет города Новополоцка

1.5.Объем закупаемых услуг, условия и сроки оплаты:

№ п/п	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг)	Условия оплаты товаров (работ, услуг)	Срок выполнения работ
1	Услуги по ремонту стерилизатора парового ГПД-560-2 Приложение №1	На основании технической эксплуатационной документации производителя оборудования необходимо восстановить работоспособность оборудования.. В соответствии с «Инструкцией об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78»	Лот 1	По факту выполненных работ на основании подписанного сторонами акта выполненных работ.	В течение 30(тридцати) календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон.

1.6. Участник должен представить следующие документы:

1.6.1 заверенную в установленном порядке копию заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию стерилизационного оборудования и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 (далее – заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять услуги по ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

- работы по ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры.

Не требуется наличие документов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, для выполнения работ по ремонту медицинской техники:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимся производителем данной медицинской техники;

- в период гарантийного срока ее эксплуатации;

- поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;

- изъятой в собственность государства;

- изготовленной (произведенной) до 2000 года.

1.6.2. заверенную в установленном порядке копию специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, выдаваемое в соответствии с законодательством Республики Беларусь (в части проведения работ по ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением).

1.7. в стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки;

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к товарам услугам)

2.1. Содержание, порядок и качество выполнения оказания услуг по ремонту осуществляются в соответствии с требованиями

эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78.

2.2. Все услуги производятся по месту эксплуатации медицинской техники на территории Заказчика в рабочее время с 8:00 – 16:00.

2.3. Выполненные услуги по ремонту медицинской техники оформляются актом выполненных работ (оказанных услуг).

2.4. Запчасти должны быть 100% совместимы с оборудованием, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

2.5. Допускается использование аналога запасной части, по качеству и техническим характеристикам не ниже указанных.

2.6. По окончании работ Исполнитель должен предоставить:


2.6.1. акт технического состояния (заключение, отчет) о степени исправности и работоспособности медицинской техники.

2.6.2. по окончанию выполнения работ Исполнитель должен предоставить акт установки запасных частей с указанием наличия драгоценных металлов.

2.6.3. гарантийный срок на замененные в ходе ремонта материалы устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее трех месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.

2.7. Специалистом, выполнившим работы по ремонту медицинской техники, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания медицинской техники Заказчика.

Разработал: инженер
(по радиационной безопасности)



Н.Н.Астапенко

Согласовано:

Начальник отдела по ремонту
оборудования



Е.В.Хромова

Юрисконсульт:



Е.Г.Вроцкая

Приложение 1

Услуг по ремонту парового стерилизатора BMT Sterivap HP 6612-2 SL ED						
Номер лота	Наименование оборудования	Тип, марка	Год выпуска	Заводской номер	Кол-во, шт.	Примечание
						Производитель
1	2	3	4	5	6	7
1	Стерилизатор паровой	ГПД-560-2	2017	7	1	Замена тэнов (материал заказчика), кроме прокладок для тэнов, Дефектный акт ЧП «Сапмедик» от 05.05.2026г.
						АО «ТЗМОИ»



SupMedic

05.05.2026 г.

г. Минск


Дефектный АКТ

Представителем Частного предприятия «Супмедик» в УЗ «Новополоцкая центральная городская больница», по адресу: 211440, г. Новополоцк, ул. Гайдара, 4, было произведено обследование:

Наименования оборудования	Выявленные дефекты оборудования	Перечень работ для восстановления оборудования	Стоимость материалов и работ на день выставления акта, руб.
Стерилизатор паровой ГПД-560-2 «ТЗМОИ» Зав. №: 7	- Выход из строя ТЭНов парогенератора - 6 шт.;	- Замена ТЭНов парогенератора - 6 шт. (материалы Заказчика) с заменой прокладки парогенератора - 1 шт. (материалы Заказчика); - Замена прокладок ТЭНов - 12 шт. (материалы Исполнителя).	1222,08

Исполнитель:

Инженер по ремонту МТ _____ П.А.Пилипенко

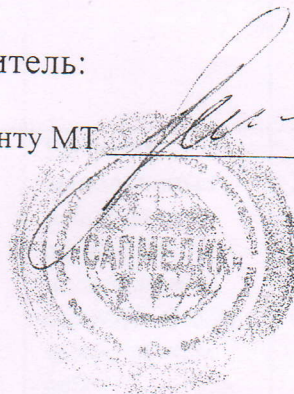

Частное производственно-торговое
унитарное предприятие
«Супмедик»

220035, г. Минск, ул. Чехова, 3, оф. 1, комн. 1
УНП 191687428 ОКПО 380027865000, лицензия №02040/7075
Р/с BY62SLAN30121298300190000000 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) код
SLANBY22, 220007 г. Минск, ул. Московская, дом 14. Дополнительный офис
№2, г. Минск, ул. Гикало, д. 3.
Тел.: (029) 307-84-36 Тел./Факс: (017) 282 40 80
supmedic@gmail.com