

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 УЗ «Брестская областная клиническая
 больница»
 А.С. Карпицкий
 _____ 2026 г.

Задание на закупку

светильника хирургического потолочного двухкупольного (2 ед)

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Светильник хирургический потолочный двухкупольный	1
1.1	Блок осветительный основной с сенсорной панелью управления функциями светильника	1
1.2	Блок осветительный вспомогательный (дополнительный) с сенсорной панелью управления функциями светильника	1
1.3	Крепление к потолку	1
1.4	Система подвесов для позиционирования осветительных блоков в любой плоскости	2
1.5	Стерилизуемая рукоятка для управления осветительным блоком	6
1.6	Источник бесперебойного питания	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Технические требования	Значение параметра или наличие функции
2.1.	Характеристики блока осветительного основного с сенсорной панелью управления функциями светильника	
2.1.1.*	Центральная освещенность на расстоянии 1 м, кЛк	Не менее 160 кЛк
2.1.2*	Функции управления размером светового поля, освещенности и цветовой температуры с помощью сенсорной панели управления, находящейся на осветительном блоке или кардане осветительного блока.	наличие

УП «Медтехника»
 г. Барановичи
 09 ИЮН 2026
 Вх. № _____

2.1.3	Изменение уровня освещенности по 10 уровням (ступеням), в пределах	от 10% до 100%
2.1.4*	Изменение цветовой температуры не менее 5 ступеней, в диапазоне не уже	От 3800K до 5500K
2.1.5	Индекс цветопередачи Ra, не менее	96
2.1.6	Индекс цветопередачи R9, не менее	96
2.1.7	Индекс цветопередачи R13, не менее	96
2.1.8	Диаметр светового поля d10(регулируемый без изменения центральной освещенности), мм	230-350
2.1.9	Диаметр светового поля d50(регулируемый без изменения центральной освещенности), мм	170-190
2.1.10	Эндо-режим	наличие
2.1.11	Глубина освещения 20%, мм не менее	1400
2.1.12	Глубина освещения 60%, мм не менее	700
2.1.13*	Функция «управление затенением»	наличие
2.1.14	Срок службы светодиодов, часы, не менее	60 000
2.1.15	Степень защиты корпуса осветительного блока, IP не менее	42
2.1.16*	Режим синхронизации работы осветительных блоков	наличие
2.1.17	Угол поворота плеча поперечной балки, не менее	310 °
2.2.	Характеристики блока осветительного вспомогательного (дополнительного) с сенсорной панелью управления функциями светильника	
2.2.1*	Центральная освещенность на расстоянии 1 м, не менее кЛк	130 кЛк
2.2.2*	Функция управления размером светового поля, освещенностью и цветовой температурой с помощью сенсорной панели управления, находящейся на осветительном блоке или кардане осветительного блока.	наличие
2.2.3	Изменение уровня освещенности по 10 уровням (ступеням) в пределах	от 10% до 100%
2.2.4*	Изменение цветовой температуры не менее 5 ступеней в диапазоне, не уже	От 3800K до 5500K
2.2.5	Индекс цветопередачи Ra, не менее	96
2.2.6	Индекс цветопередачи R9, не менее	96
2.2.7	Индекс цветопередачи R13, не менее	96

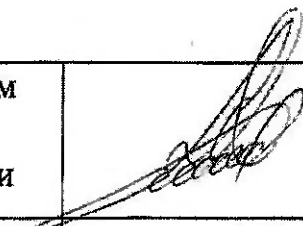
2.2.8	Диаметр светового поля d10(регулируемый без изменения центральной освещенности), мм	250-340
2.2.9	Диаметр светового поля d50(регулируемый без изменения центральной освещенности), мм	160-180
2.2.10	Эндо-режим	наличие
2.2.11	Глубина освещения 20%, мм не менее	1200
2.2.12	Глубина освещения 60%, мм не менее	650
2.2.13*	Функция «управление затенением»	наличие
2.2.14	Срок службы светодиодов, часы, не менее	60 000
2.2.15	Степень защиты корпуса осветительного блока, IP не менее	42
2.2.16*	Режим синхронизации работы осветительных блоков	наличие
2.2.17	Угол поворота плеча поперечной балки, не менее	310 °
2.3.	Источник бесперебойного питания	наличие
2.3.1	Время работы светильника от ИБП, часы, не менее	4

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).


3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Примечание: при несоответствии параметров , отмеченных астериском (*) предложение снимается с рассмотрения.

Разработчики технических требований:

1	Дейкало Максим Викторович	Зав. отделением хирургии и трансплантации	
2	Гетманюк Сергей Владимирович	И.о. зав. отделением нейрохирургии	

Согласовано:

 Сабалевский Игорь Валентинович главный внештатный специалист
ГУЗО Брестского облисполкома (Специалист по стационарной хирургии)

