

Лот 2 Кровать медицинского назначения

Необходимое количество закупаемых изделий 64 шт.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

1.1	Кровать медицинского назначения для длительного ухода за больными	1 комплект
1.2.	Инфузионная стойка, регулируемая по высоте.	2 шт.
1.3.	Центральная система блокировки колес.	наличие
1.4.	Функция CPR	наличие
1.5.	Пульт дистанционного управления	1 шт.
1.6.	Встроенные весы	1 шт
1.7.	Матрас	1 шт
1.8.	Дуга для подтягивания	наличие

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№		Параметр
2.1*	Максимальная нагрузка, кг не менее	250
2.2	Максимальная длина, мм не более	2200
2.3	Максимальная ширина, мм не более	1100
2.4	Высота общая, мм	825-1010
2.5	Диаметр колес, мм не менее	125
2.6	Материал рамы, каркаса, основы	Стальной профиль
2.7	Количество секций	4
2.8*	Верхняя часть ее выполнена из прозрачного пластика, не создающего препятствия для рентгеновских лучей	наличие
2.9	Регулировка спинной секции при помощи пульта дистанционного управления.	не менее 60°
2.10	Регулировка бедренной секции при помощи пульта дистанционного управления.	не менее 30°
2.11	Регулировка голеностопной секции.	не менее 10°
2.12	Регулировка Тренделенбург.	не менее 12°
2.13	Регулировка анти-Тренделенбург.	не менее 10°
2.14	Кровать должна комплектоваться складывающимися боковыми ограждениями на всю длину кровати	наличие

2.15	Протекторы-бамперы, расположенные по углам кровати, для предотвращения ударов о стены при перемещениях.	наличие
2.16	Электрический привод	наличие
2.17*	Встроенные весы с управлением и выводом показаний на панели управления для персонала.	наличие
2.19	Внутренний блок матраса изготовлен из высокоэластичной пены повышенной плотности.	наличие
2.20	Влагонепроницаемый чехол для матраса изготовлен из медицинской клеёнки или ткани с полиуретановой мембраной, подходящей для обработки медицинскими реагентами, согласно инструкции.	наличие
2.21	*Изголовье и изножье: съёмные, выполнены из ударопрочного ABS-пластика, легко очищаемого и устойчивого к повреждениям.	наличие

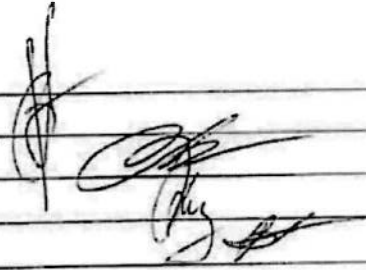
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.


Примечание:

*) данные требования технического задания определяют уровень функциональных возможностей оборудования, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений

Разработчики технических требований:

1	В.В.Жоглов, заведующий РАО2	
2.	А.И. Тихон, заведующий РАО1	
3	А.Л.Немкевич, врач-анестезиолог	
4	В.Е. Билида, врач-анестезиолог	

Согласовано:

 В.В.Гоменюк главный внештатный специалист ГУЗО Брестского облисполкома (Специалист по анестезиологии и реанимации)