

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Набор для автоматической деглицеролизации и отмывания криоконсервированных эритроцитов на аппарате АСР 215 состоящий из: - линия гипертонического раствора с полимерной иглой с колпачком; - линия промывочного раствора с полимерной иглой с колпачком; - линия добавочного раствора с коннектором; - колокол центрифужный; - антибактериальный фильтр растворов; - сегмент с ограничителями для насоса раствора; - сегмент с ограничителями для насоса крови; - линия датчика давления потока забора с гидрофобным фильтром; - линия датчика давления системы с гидрофобным фильтром; - герметичная трубка (магистраль) для стерильного соединения с контейнером с эритроцитами; - контейнер для сбора промывной жидкости; - контейнер для хранения и переливания компонента крови; - зажимы на линиях датчиков с фильтрами, линиях гипертонического раствора, промывочного раствора, добавочного раствора.	набор	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

*2.1. Набор совместим с аппаратом АСР 215 в соответствии с протоколами «Деглицеролизация» и обеспечивает безопасность и качество полученного компонента крови.

2.2. Набор - одноразовая, стерильная, закрытая система.

2.3. Диаметр герметичной трубки (магистральной) для стерильного соединения с контейнером с эритроцитами при помощи устройства для стерильного соединения - $4,2 \text{ мм} \pm 0,3 \text{ мм}$, с внутренним диаметром $3,0 \pm 0,1 \text{ мм}$.

2.4. Объем центрифужного колокола – 275 мл; объем контейнера для сбора промывной жидкости – не менее 3000 мл; объем контейнера для хранения и переливания готового продукта – не менее 350 мл.

2.5. Диаметр пор антибактериального фильтра растворов и гидрофобных фильтров – не более 0,22 мкм;

2.6. Упаковка набора обеспечивает стерильность набора и защиту его от влаги.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №753/26

Лот №2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Раствор для деглицеролизации натрия хлорид 12% (далее – раствор)	штук	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)

2.1. Раствор - прозрачный, бесцветный, стерильный, апиrogenный, нетоксичный.

2.2. Состав раствора: натрия хлорид - 12 г, вода для инъекций – до 100 мл.

*2.3. Инъекционный порт обеспечивает герметичное подключение раствора к полимерной игле линии гипертонического раствора набора для деглицеролизации и промывания эритроцитов, совместимого с аппаратом АСР 215.

2.4. Наличие петли для подвешивания с раствора.

2.5. Объем раствора – не менее 250 мл.

2.6. Этикетка на первичной упаковке раствора должна содержать

информацию о растворе (состав, срок годности), производителе раствора.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №753/26

Лот №3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Раствор промывочный 0,2% глюкозы, 0,9% натрия хлорида (далее – раствор)	штук	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)

2.1. Раствор - прозрачный, стерильный, апиrogenный, нетоксичный.

2.2. Состав раствора: натрия хлорид – 0,9 г, глюкоза моногидрат – 0,2 г, натрия дигидрогенофосфат дигидрат – 0,034 г, динатрия фосфат додекагидрат – 0,209 г, вода для инъекций – до 100 мл.

*2.3. Инъекционный порт обеспечивает герметичное подключение раствора к полимерной игле линии промывочного раствора набора для деглицеролизации и промывания эритроцитов, совместимого с аппаратом АСР 215.

2.4. Наличие петли для подвешивания раствора.

2.5. Объем раствора – не менее 2000 мл.

2.6. Этикетка на первичной упаковке должна содержать информацию о растворе (состав, срок годности), производителе раствора.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Раствор SAGM (далее – раствор)	штук	250

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)

2.1. Прозрачный, стерильный, апиrogenный, нетоксичный.

2.2. Состав: аденин - 0,017 г, декстроза моногидрат - 0,9 г, маннитол – 0,525 г, натрия хлорид – 0,877 г, вода для инъекций – до 100 мл.

*2.3. Инъекционный порт обеспечивает герметичное подключение раствора к коннектору набора для деглицеролизации и промывания эритроцитов, совместимого с аппаратом АСР 215.

2.4. Наличие петли для подвешивания раствора.

2.5. Объем раствора – не менее 350 мл.

2.6. Этикетка на первичной упаковке должна содержать информацию о растворе (состав, срок годности), о производителе раствора.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Набор для автоматического отмывания эритроцитов на аппарате АСР 215 состоящий из: - линия гипертонического раствора с полимерной иглой с колпачком; - линия промывочного раствора с полимерной иглой с колпачком; - линия добавочного раствора с коннектором; - колокол центрифужный; - антибактериальный фильтр растворов; - сегмент с ограничителями для насоса раствора; - сегмент с ограничителями для насоса крови; - линия датчика давления потока забора с гидрофобным фильтром; - линия датчика давления системы с гидрофобным фильтром; - герметичная трубка (магистраль) для стерильного соединения с контейнером с эритроцитами; - контейнер для сбора промывной жидкости; - контейнер для хранения и переливания компонента крови; - зажимы на линиях датчиков с фильтрами, линиях гипертонического раствора, промывочного раствора, добавочного раствора.	набор	650

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)

*2.1. Набор совместим с аппаратом АСР 215 в соответствии с протоколом «Отмывание клеток» и обеспечивает безопасность и качество полученного компонента крови.

2.2. Набор - одноразовая, стерильная, закрытая система.

2.3. Диаметр герметичной трубки (магистральной) для стерильного соединения с контейнером с эритроцитами при помощи устройства для стерильного соединения - $4,2 \text{ мм} \pm 0,3 \text{ мм}$, с внутренним диаметром $3,0 \pm 0,1 \text{ мм}$.

2.4. Объем центрифужного колокола – 275 мл; объем контейнера для сбора промывной жидкости – не менее 3000 мл; объем контейнера для хранения и переливания готового продукта – не менее 350 мл.

2.5. Диаметр пор антибактериального фильтра растворов и гидрофобных фильтров – не более 0,22 мкм;

2.6. Упаковка набора обеспечивает стерильность набора и защиту его от влаги.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Набор для автоматической глицеролизации эритроцитов на аппарате АСП 215 состоящий из: - линия раствора глицерола с вентилируемой капельницей, с полимерной иглой с колпачком и зажимом; - насосный сегмент с двумя фиксаторами; - антибактериальный фильтр линии раствора; - датчик давления системы с гидрофобным фильтром и зажимом; - герметичная трубка (магистраль) для стерильного соединения с контейнером с эритроцитами.	набор	185

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)

*2.1. Набор совместим с аппаратом АСП 215 в соответствии с протоколом «Глицеролизация», обеспечивает безопасность и качество полученного компонента крови.

2.2. Набор - одноразовая, стерильная, закрытая система.

2.3. Диаметр герметичной магистрали (трубки) для стерильного соединения с контейнером с эритроцитами при помощи устройства для стерильного соединения - $4,2 \text{ мм} \pm 0,3 \text{ мм}$, с внутренним диаметром $3,0 \pm 0,1 \text{ мм}$.

2.4. Диаметр пор антибактериального фильтра линии раствора и гидрофобного фильтра датчика давления системы – не более $0,22 \text{ мкм}$;

2.5. Упаковка набора обеспечивает стерильность набора и защиту его от влаги.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Раствор глицерола для глицеролизации и замораживания эритроцитов 57,1% (далее - раствор)	штук	230

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)

2.1. Раствор – прозрачный, бесцветный; стерильный, апиrogenный, нетоксичный.

2.2. Состав раствора: глицерол – 571 г, натрия лактат раствор 60% – 26,67 г, калия хлорид – 0,3 г, мононатрия фосфат моногидрат – 0,86 г, динатрия фосфат додекагидрат – 2,27 г, вода для инъекций – до 1000 мл.

*2.3. Инъекционный порт раствора обеспечивает герметичное подключение к полимерной игле линии раствора глицерола набора для глицеролизации, совместимого с аппаратом АСР 215.

2.4. Объем раствора – не менее 500 мл.

2.5. Этикетка на первичной упаковке раствора должна содержать информацию о растворе (состав, срок годности), производителе раствора.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Контейнер одинарный, пустой (1000 мл) с входящей трубкой, штуцерами (портами) (далее – контейнер)	штук	150

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)

2.1. Одноразовый, стерильный, апиrogenный, нетоксичный.

*2.2. Объем контейнера – 1000 мл.

2.3. Длина входящей трубки - не менее 30 см.

2.4. Входящая трубка контейнера снабжена полимерной иглой с колпачком.

2.5. Штуцеры (порты) контейнера снабжены мембраной и элементом «первого вскрытия».

2.6. Пригодность входящей трубки для проведения герметизации контейнера методами термического запаивания (заваривания).


2.7. Диаметр входящей трубки - $4,2 \text{ мм} \pm 0,3 \text{ мм}$, с внутренним диаметром $3,0 \pm 0,1 \text{ мм}$ для стерильного соединения с контейнером эритроцитов.

2.8. Наличие петель для подвешивания.

*2.9. Контейнер сохраняет целостность при проведении центрифугирования.

2.10. Упаковка обеспечивает стерильность контейнера и защиту его от влаги.

Примерная схема контейнер одинарного пустого (1000 мл).

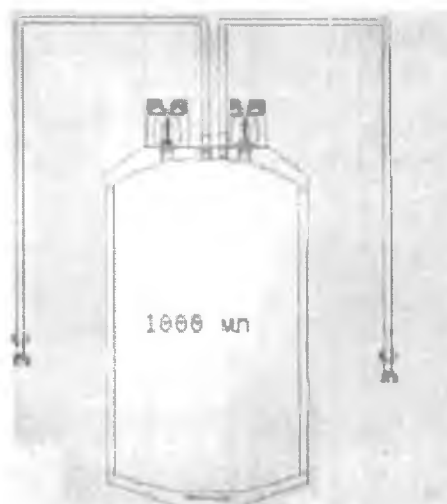

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*) является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.