

# ЛОТ 1

## Приложение к заявке на закупку медицинских изделий

### Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

#### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №<br>п/п | Наименование                                                       | Кол-во |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.1.     | <b>Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой</b> | 1 шт.  |
| 1.1.1.   | Педальный переключатель (с функцией переключения режимов)          | 1 шт.  |
| 1.1.2.   | Нейтральный электрод многоразовый                                  | 4 шт.  |
| 1.1.3.   | Шнур соединительный к нейтральному электроду многоразовому         | 4 шт.  |

#### 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные по статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

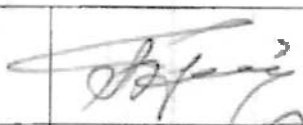

| № п/п  | Наименование / Технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.   | Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.1. | сенсорный экран управления аппаратом;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.2. | функции «автостарт» и «автостоп»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.3. | рабочая частота генератора для 5 мм УЗ-инструментов – не менее 47 кГц;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1.4. | не менее 4-х режимов монополярного рассеечения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.5. | не менее 4-х режимов монополярной коагуляции;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1.6. | не менее 2-х режимов биполярного рассеечения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1.7. | не менее 7-х режимов биполярной коагуляции;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.8. | характеристики монополярных режимов:<br>- мощность аппарата при монополярном сечении не менее 300 Вт;<br>- смешанное резание-коагуляция, мощность не менее 200 Вт;<br>- коагуляция глубокая, мощность не менее 200 Вт;<br>- коагуляция поверхностная, мощность не менее 120 Вт;<br>- коагуляция форсированная, мощность не менее 120 Вт;<br>- коагуляция SPRAY, мощность не менее 120 Вт; |
| 2.1.9. | характеристики биполярных режимов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- резание, мощность не менее 100 Вт;</li> <li>- резание в жидкости, мощность не менее 320 Вт;</li> <li>- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;</li> <li>- коагуляция в жидкости, мощность не менее 200 Вт;</li> <li>- коагуляция с контролируемым сопротивлением ткани (лигирование, с автостопом), мощность не менее 120 Вт;</li> </ul> |
| 2.1.10. | <p>характеристики УЗ-режимов работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- биполярная коагуляция с контролем степени коагуляции ткани и рассечением ультразвуком одним инструментом;</li> <li>- резание и коагуляция при помощи ультразвука в одном инструменте;</li> </ul>                                                                                                       |
| 2.1.11. | максимальную выходную мощность для УЗ-режима – не менее 70Вт;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.12. | количество эффектов – не менее 3-х (изменение параметров резания/коагуляции без изменения мощности);                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.13. | наличие режима работы в «солевом» растворе, для использования с биполярными резектоскопами;                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.14. | <p>Разъемы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не менее 2-х монополярных;</li> <li>- не менее 2-х биполярных;</li> <li>- разъем для подключения комбинированного инструмента для контролируемой коагуляции ткани и рассечения ультразвуком/ разъем для подключения ультразвукового скальпеля.;</li> </ul>                                                                      |


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1 Согласно аукционным документам организатора

Разработчики технических требований:

|   |                          |           |                                           |                                                                                       |
|---|--------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Бородинчик<br>Николаевич | Геннадий  | Заведующий<br>урологическим<br>отделением |  |
| 2 | Игнатюк<br>Николаевич    | Александр | заведующий<br>операционным<br>отделением  |  |

Согласовано:

 Сабалевский Игорь Валентинович главный внештатный специалист ГУЗО Брестского облисполкома (Специалист по стационарной хирургии)