

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий


N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Центрифуга лабораторная	шт.	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

Технические характеристики

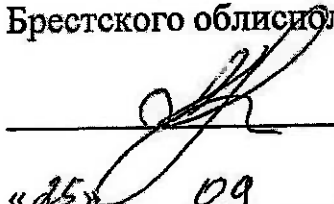
2.1	Источник питания	220 В
2.2	Максимальная вместимость углового ротора	8-12 пробирок
2.3	Применение стандартных пробирок всех размеров (вакутайнеры)	от 2 до 10 мл
2.4	Скорость вращения	2000-4500 об/мин
2.5	Установка времени центрифугирования	до 99 мин, по таймеру
2.6	Тип	Настольная, малогабаритная
2.7	Дисплей	наличие
2.8	Уровень шума	≤63 Дб
2.9	функция кратковременного запуска	наличие
2.10	функция звукового оповещения;	наличие
2.11	блокировка крышки во время центрифугирования и блокировка старта центрифуги при открытой крышке	наличие
2.12	аварийное открывание крышки	наличие

Разработчики технических требований:

Ф.И.О.	Должность	Подпись
Зубкова Е.В.	Заведующий отделением патологии беременности	
Воеводова Е.Л.	Заведующий клинико-диагностической лабораторией	

СОГЛАСОВАНО

Главный внештатный специалист
по клинической лабораторной диагностике
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома

 А.В. Маркевич

«25» 09 2026